

**ЗАКАЗАТЬ**

ООО «Энерго-Союз»



Устройства измерительные ЦР 9002

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
УИМЯ.411600.072 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для ознакомления с техническими характеристиками, принципом работы, устройством и обслуживанием устройств измерительных ЦР 9002 (далее – измерители).

## 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

### 1.1 Назначение

1.1.1 Измерители предназначены для дистанционного непрерывного измерения температуры (датчик температуры может поставляться по отдельному заказу) и отображения ее значения на отсчетном устройстве, передачи результатов измерения с использованием порта RS-485, а также для преобразования измеренного значения температуры в унифицированный электрический сигнал постоянного тока.

В качестве термодатчика могут быть использованы термопреобразователи сопротивления (далее – ТС), подключаемые по трехпроводной или четырехпроводной схеме, или термопары.

Связь с ПЭВМ осуществляется в соответствии с протоколом обмена данными MODBUS. Описание протокола приведено в приложении А.

Наличие двух встроенных реле позволяет проводить их включение или отключение по определенному алгоритму в зависимости от измеренной температуры.

1.1.2 Измерители предназначены для эксплуатации при температуре от минус 25 °C до плюс 50°C .

1.1.3 Измерители относятся к оборудованию, эксплуатируемому в стационарных условиях производственных помещений

### 1.2 Технические характеристики

1.2.1 Тип применяемого ТС по ГОСТ 6651-2009, обозначение типа ТС, температурный коэффициент  $\alpha$ , номинальное сопротивление ТС  $R_0$ , диапазон сопротивления ТС, диапазон измерений, величина диапазона измерений  $\Delta T$ , сопротивление подводящих проводников указаны в таблице 1.

Таблица 1

Тип применяемого ТС по ГОСТ 6651-2009	Обозначение типа ТС	$\alpha$ , $^{\circ}\text{C}^{-1}$	$R_0$ , Ом	Диапазон сопротивления ТС, Ом	Диапазон измерений, от Тмин до Тмакс, $^{\circ}\text{C}$	$\Delta T$ , $^{\circ}\text{C}$ (Тмакс - Тмин)	Точность преобразования температуры, $^{\circ}\text{C}$	Сопротивление подводящих проводников, Ом
платиновый	Pt	0,00385	100	От 60,26 до 390,48	от минус 100 до плюс 850	950	4,8	не более 60
			50	От 30,13 до 195,24			4,8	
	П	0,00391	100	От 59,64 до 395,16	от минус 100 до плюс 850	950	4,8	
			50	От 29,82 до 197,58			4,8	
медный	M	0,00426	100	От 78,7 до 185,2	от минус 50 до плюс 200	250	1,3	не более 60
			50	От 39,35 до 92,6			1,3	
		0,00428	100	От 56,54 до 185,60	от минус 100 до плюс 200	300	1,5	
			50	От 28,27 до 92,8			1,5	
никелевый	H	0,00617	100	От 69,45 до 223,21	от минус 60 до плюс 180	240	1,2	

Примечание - Сопротивление всех подводящих проводников должно быть одинаковым.

Обозначение термопары по СТБ ГОСТ Р 8.585-2004, тип термопары, диапазон измерений (диапазон преобразования температур), величина диапазона измерений (диапазона преобразований температур)  $\Delta T$  указаны в таблице 2.

Изм	Лист	N докум.	Подп	Дата	УИМЯ.411600.072 РЭ		
Разраб.		Семенас			Lит.	Лист	Листов
Пров.		Бабора			01	2	29
Н.контр.		Семенас					
Утв.		Жарков					
Инв № подл		Подп. и дата			Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата

Таблица 2

Обозначение термопары по СТБ ГОСТ Р 8.585-2004	Тип термо-пары	ТЭДС, мВ	Диапазон измерений, от Тмин до Тмакс, °C	ΔT(Тмакс - Тмин), °C	Точность преобразования температуры, °C
ТПП	R	От - 0,226 до + 20,877	от - 50 до + 1750	1800	9/18
ТПП	S	От - 0,236 до + 18,503	от - 50 до + 1750	1800	9/18
ТПР	B	От + 0,291 до + 13,591	от + 250 до + 1800	1550	8/16
ТЖК	J	От - 4,633 до + 69,553	от - 100 до + 1200	1300	7
ТМК	T	От - 3,379 до + 20,872	от - 100 до + 400	500	2,5
TXKh	E	От - 5,237 до + 76,373	от - 100 до + 1000	1100	6
TXA	K	От - 3,554 до + 48,838	от - 100 до + 1200	1300	7
THH	N	От - 2,407 до + 47,513	от - 100 до + 1300	1400	7
TXK	L	От - 5,641 до + 66,466	от - 100 до + 800	900	4,5

Примечание - Точность преобразования температуры для термопар типа R, S, B указана через дробь для измерителей класса точности 0,5 и 1,0 соответственно (п.1.2.3)

1.2.2 Номинальное значение выходного аналогового сигнала для измерителей, имеющих аналоговый выход, определяется потребителем при заказе и может быть 20 или 5 мА.

Диапазон сопротивления нагрузки от 10 Ом до 0,5 кОм для измерителей с номинальным значением выходного аналогового сигнала 20 мА, от 10 Ом до 3 кОм для измерителей с номинальным значением выходного аналогового сигнала 5 мА.

Примечание. При номинальном значении выходного аналогового сигнала 20 мА потребитель может, непосредственно в месте установки, выбрать один из следующих диапазонов: от 0 до 20 мА или от 4 до 20 мА.

При номинальном значении выходного аналогового сигнала 5 мА потребитель может, непосредственно в месте установки, выбрать один из следующих диапазонов: от 0 до 5 мА или от минус 5 до плюс 5 мА.

1.2.3 Допускаемый ток, коммутируемый каждым реле 1,0 А. Допускаемое напряжение, коммутируемое каждым реле 250 В переменного тока, либо 30 В постоянного тока.

1.2.4 Класс точности измерителей - 0,5 или 1,0 в зависимости от кода типа термодатчиков, с которыми может работать измеритель.

Коду 1 типа термодатчиков соответствует измеритель, имеющий класс точности 0,5 при работе со всеми типами ТС и с термопарами типа J, T, E, K, N, L, и имеющий класс точности 1,0 при работе с термопарами типа R, S, B.

Коду 2 типа термодатчиков соответствует измеритель, имеющий класс точности 0,5 при работе с термопарами типа R, S, B.

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерителей должны быть равны соответственно  $\pm 0,5\%$  или  $\pm 1,0\%$  от нормирующего значения Аномр.

Для измерителей, имеющих аналоговый выход, пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерителей должны быть равны соответственно  $\pm 0,5\%$  или  $\pm 1,0\%$  от нормирующего значения Аномр во всем диапазоне сопротивления нагрузки.

Аномр для отсчетного устройства равно величине диапазона ΔT, указанной в таблицах 1 и 2.

Аномр для аналогового выхода равно номинальному значению выходного аналогового сигнала.

Аномр для выхода RS-485, в единицах, рассчитывается по формуле

$$\text{Аномр} = 10 \times \Delta T / 1^{\circ}\text{C} \quad (1)$$

1.2.5 Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормального значения до любой температуры в пределах рабочих условий применения на каждые  $10^{\circ}\text{C}$ , не превышают  $\pm 0,5$  предела допускаемой основной приведенной погрешности.

1.2.6 Питание измерителей осуществляется по одному из следующих вариантов:

а) от источника напряжения переменного тока от 198 до 242 В (номинальное значение 220 В\*) и частотой 50 Гц;

б) от источника напряжения от 85 до 264 В (номинальное значение 220 В) переменного тока частотой 50 Гц или от источника напряжения от 120 до 300 В (номинальное значение 220 В) постоянного тока (да-

Лист	УИМЯ.411600.072 РЭ	3
Зам	УИМЯ.022-2018	06.08.18
Изм	№ докум.	Подп. Дата
Инв № подл	Подп. и дата	Взам. инв №
Инв. № подл		Подп. и дата

лее – универсальное питание).

в) от источника напряжения постоянного тока от 18 до 36 В (номинальное значение 24 В).

\* - при поставках в РФ номинальное значение 230 В.

Пределы допускаемой дополнительной погрешности ИП, вызванной изменением напряжения питания от номинального до минимального и максимального значений, не превышают предела допускаемой основной приведенной погрешности

1.2.7 Время установления рабочего режима измерителей не более 30 мин.

По истечении времени установления рабочего режима измерители соответствуют требованию п. 1.2.3 независимо от продолжительности включения.

1.2.8 Пульсация выходного сигнала на аналоговом выходе измерителей не более 75 мВ для измерителей с номинальным значением выходного аналогового сигнала 5 мА и 50 мВ для измерителей с номинальным значением выходного аналогового сигнала 20 мА на максимальной нагрузке.

1.2.9 Мощность, потребляемая измерителями от источника питания, не более 5 В·А (5 Вт).

1.2.10 Габаритные размеры измерителей не более 72x72x100 мм. Габаритные и установочные размеры измерителей приведены в приложении Б.

1.2.11 Масса измерителей не более 0,4 кг.

1.2.12 Электрическая изоляция цепей измерителей выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой 45-55 Гц, величина которого указана в таблице 3.

Таблица 3

Наименование цепей	Испытательное напряжение, кВ	
	Номинальное значение напряжения питания, В	
	220	24
Цель питания – Контакты реле, Аналоговый выход, Входы, RS-485	3,0	2,7
Корпус – Цепи питания, Контакты реле		
Корпус – Аналоговый выход, Входы, RS-485	0,85	
Контакты реле – Входы, Аналоговый выход, RS-485	1,04	
Вход – Аналоговый выход, RS-485		0,85
Аналоговый выход – RS-485		

Примечание - При проверке изоляции необходимо учитывать наличие или отсутствие цепей в конкретном измерителе

Электрическое сопротивление изоляции в нормальных условиях цепей, указанных в таблице 3, не менее 20 МОм

1.2.13 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, IP20 по ГОСТ 14254-2015.

1.2.14 Средний срок службы не менее 12 лет.

### 1.3 Устройство и работа

#### 1.3.1 Описание конструкции измерителя

Измеритель конструктивно состоит из следующих основных узлов: кожуха и крышки с табличкой, на которой нанесена необходимая маркировка. Крышка с табличкой является частью лицевой панели, на которой находится кнопка управления «В», отчетное устройство и светодиоды индикации состояния реле и светодиод отображения температуры холодного спая. Светящийся светодиод состояния реле свидетельствует о замкнутом состоянии соответствующего реле K1 или K2. Светящийся светодиод Тхс свидетельствует о том, что в настоящий момент на отчетном устройстве индицируется температура холодного спая.

Внутри измерителя расположены три платы:

- плата обработки и реле;
- плата индикации;
- плата питания, аналогового выхода и интерфейса RS-485.

Лист	УИМЯ.411600.072 РЭ				
3	Зам	УИМЯ.022-2018	06.08.18	Изм	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Инв № подл	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата	

Для внешнего подключения используются две клеммные колодки со съемными разъемами. Кожух и крышка выполнены из изоляционного материала. Крепление на щите осуществляется с помощью двух скоб, закрепленных на кожухе измерителя. Схема электрическая подключения термодатчиков при работе с измерителем приведена в приложении В.

Описание режимов индикации ОУ приведено в приложении Г.

Пример условного обозначения при заказе измерителя приведен в приложении Д.

#### 1.4 Маркировка и пломбирование

1.4.1 На лицевой стороне измерителей нанесены:

- тип измерителя;
- обозначение единиц измерения температуры;
- знак Государственного реестра;
- товарный знак изготовителя;
- код степени защиты, обеспечиваемой оболочкой (IP20);
- символ оборудования, защищенного двойной или усиленной изоляцией (символ 014 по ГОСТ 25874-83);
- обозначение светодиодов состояния реле (K1 и K2);
- обозначение светодиода отображения на отчетном устройстве температуры холодного спая (Txс);
- надпись «Сделано в Беларусь».

На кожухе, со стороны клеммных колодок подключения, нанесены:

- обозначения рода тока, номинальное значение и единицы измерения выходного аналогового сигнала;
- обозначение единицы измерения и максимальное сопротивление нагрузки аналогового выхода;
- порядковый номер по системе нумерации изготовителя, где первые цифры – две последние цифры года выпуска;
- надпись с условным обозначением вида питания (по ГОСТ 30012.1-2002), номинальные значения частоты, напряжения источника питания и мощности, потребляемой от источника питания;
- тип измерителя и его цифровой код.

На кожухе сверху должна быть нанесена схема подключения термодатчиков с обозначением полярности сигналов на зажимах.

## 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Электрооборудование здания, в котором устанавливаются измерители, должно содержать устройство защиты с током срабатывания  $I_{\text{ном}}=50$  мА и граничными значениями времени срабатывания  $t_{\text{мин}}=200$  мс и  $t_{\text{макс}}=2$  с.

Внешние подключения измерителей должны выполняться при помощи клеммных колодок соединением под винт.

Соединения должны выполняться медными или алюминиевыми проводами сечением от 0,5 до 1,5 мм<sup>2</sup>.

#### 2.2 Меры безопасности

Персонал, допущенный к работе с измерителем, должен:

- знать измеритель в объеме настоящего руководства по эксплуатации;
- соблюдать требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

#### 2.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ВСКРЫВАТЬ ИЗМЕРИТЕЛЬ;
- ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ИЗМЕРИТЕЛЬ В УСЛОВИЯХ И РЕЖИМАХ, ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ОТ УКАЗАННЫХ В РАЗДЕЛЕ 1 НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ;
- ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ИЗМЕРИТЕЛЬ ПРИ ОБРЫВАХ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ;

Лист	УИМЯ.411600.072 РЭ					
Зам	УИМЯ.022-2018	06.08.18	Инв № подл	Подп. и дата	Инв № подл	Подп. и дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
5						

– ПРОИЗВОДИТЬ ВНЕШНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ, НЕ ОТКЛЮЧИВ ЦЕПИ ПИТАНИЯ И ВХОДНОГО СИГНАЛА.

2.4 Опасный фактор – напряжение питания.

Меры защиты от опасного фактора – проверка электрического сопротивления изоляции.

В случае возникновения аварийных условий и режимов работы измеритель необходимо немедленно отключить.

2.5 Противопожарная защита в помещениях, где эксплуатируется прибор, должна достигаться:

- а) применением автоматических установок пожарной сигнализации;
- б) применением средств пожаротушения;
- в) организацией своевременного оповещения и эвакуации людей.

### 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Эксплуатационный надзор за работой измерителя производится лицами, за которыми закреплено данное оборудование.

3.2 Планово-предупредительный осмотр

Планово-предупредительный осмотр (ППО) производят в сроки, предусмотренные соответствующей инструкцией потребителя.

Порядок ППО:

- отсоединить оба разъема;
- произвести наружный осмотр измерителя, сухой ветошью удалить с корпуса грязь и влагу;
- убедиться в отсутствии механических повреждений, проверить состояние крепления;
- присоединить разъемы.

3.3 Проверка измерителя проводится в соответствии с методикой поверки.

Межповерочный интервал – не более 12 месяцев при использовании в сфере законодательной метрологии.

Рекомендуемый межповерочный интервал – не более 48 месяцев при использовании вне сферы законодательной метрологии.

### 4 ХРАНЕНИЕ

4.1 Хранение измерителя на складах должно производиться на стеллажах в упаковке изготавливаемого при температуре окружающего воздуха от 0 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях для хранения не должно быть пыли, а также газов и паров, вызывающих коррозию.

4.2 Хранение измерителя без упаковки должно производиться при температуре окружающего воздуха от 10 °C до 35 °C и относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °C.

4.3 В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов, вызывающих коррозию.

4.4 Поскольку измеритель не представляет опасности для жизни, здоровья людей или окружающей среды, его утилизация осуществляется в соответствии с местным законодательством.

### 5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1 При погрузке, разгрузке и транспортировании необходимо руководствоваться требованиями, обусловленными манипуляционными знаками «Верх» и «Хрупкое. Осторожно», нанесенными на транспортную тару.

5.2 Транспортирование измерителя может осуществляться железнодорожным и автомобильным транспортом.

5.3 При необходимости особых условий транспортирования это должно быть оговорено специально в договоре на поставку.

3	Зам	УИМЯ.022-2018	06.08.18	УИМЯ.411600.072 РЭ	Лист 5а
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Инв № подл		Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата

## **6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие измерителя требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации – 48 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

6.3 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления.

## **7 АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

ООО «Энерго-Союз»

Республика Беларусь

210601 г. Витебск, ул. С. Панковой 3,

тел/факс +375(212) 67-72-77,

коммерческий отдел тел/факс +375(212) 67-75-80, 67-75-98

3	Зам	УИМЯ.022-2018		06.08.18	УИМЯ.411600.072 РЭ	Лист 6
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Инв № подл	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата		

Приложение А  
(справочное)  
**Протокол обмена данными для ЦР9002**

В приборе реализован протокол обмена данными MODBUS, режим RTU.

Формат посылки – 8 бит без контроля четности.

Скорость обмена – 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 28800 бод.

Сетевой номер прибора задается потребителем в диапазоне от 1 до 255.

При выпуске из производства установлена скорость 9600. Сетевой номер 255, если иное не оговорено при заказе.

Функции MODBUS, поддерживаемые данным прибором:

Функция 1 – чтение состояния реле;

Функция 3 – чтение регистров настроек (4х – банк);

Функция 4 – чтение входных регистров (3х – банк);

Функция 6 – установка единичного регистра настроек (4х – банк).

**Функция 1** предназначена для определения состояния реле, встроенных в прибор. Формат запроса для функции 1:

SLAVE	01	START	LENGTH	CRC
-------	----	-------	--------	-----

где SLAVE                   адрес запрашиваемого прибора (1 байт);  
 01                          код функции (1 байт);  
 START                     адрес начала запрашиваемых данных (2 байта, старший затем младший);  
 LENGTH                    количество запрашиваемых данных (2 байта, старший затем младший);  
 CRC                        контрольный циклический код.

Прибор ответит только в том случае, если START = 0000h, а LENGTH = 0002h. Если START и (или) LENGTH отличны от вышеупомянутых, прибор выдает **исключение** – «неправильный адрес или данные» (см. исключения).

Формат ответа для функции 1:

SLAVE	01	01	DATA	CRC
-------	----	----	------	-----

где SLAVE                   адрес ответившего прибора (1 байт);  
 01                          код функции (1 байт);  
 01                         количество передаваемых байт данных (1 байт);  
 DATA                       байт состояния реле, где: бит 1 – состояние реле K1; бит 0 – состояние реле K2; остальные биты всегда равны «0»;  
 CRC                        контрольный циклический код.

В поле DATA, если бит установлен. это означает, что соответствующее реле включено.

**Функция 3** предназначена для определения установок (настроек) для данного прибора. Формат запроса для функции 3:

SLAVE	03	START	LENGTH	CRC
-------	----	-------	--------	-----

где SLAVE                   адрес запрашиваемого прибора (1 байт);  
 03                          код функции (1 байт);  
 START                     адрес начала запрашиваемых данных (2 байта, старший затем младший);  
 LENGTH                    количество запрашиваемых данных (2 байта, старший затем младший);  
 CRC                        контрольный циклический код.

Прибор ответит только в том случае, если START находится в диапазоне от 0000h до 000Bh, а LENGTH – от 0001h до 000Ch. При этом следует учесть следующее: START + LENGTH не должно превысить 000Ch. При запросе START = 5000h, LENGTH = 0008h слов, прибор выдаст свое наимено-

3	Зам	УИМЯ.022-2018	06.08.18	УИМЯ.411600.072 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.		7
Инв № подл	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата	

вание (коды KOI8-R) и номер версии программного обеспечения. Если START равен 5000h, а LENGTH при этом не равна 0008h слова, либо START и (или) LENGTH находятся вне указанных диапазонов, прибор выдаст **исключение** – «неправильный адрес или данные».

**Формат ответа для функции 3:**

SLAVE	03	BYTES	DATA...	CRC
-------	----	-------	---------	-----

где SLAVE                   адрес ответившего прибора (1 байт);  
 03                        код функции (1 байт);  
 BYTES                    количество передаваемых байт данных (1 байт);  
 DATA...                  собственно данные, предназначенные к обмену;  
 CRC                      контрольный циклический код.

Особенностью этой команды является то, что запрашиваются двухбайтовые данные (СЛОВА). В ответе всегда сначала старший байт, затем младший байт. Далее приведена таблица А.1, в которой сведены все возможные запрашиваемые данные с их адресами и длинами.

Таблица А.1

Наименование данных	Адрес начала данных, слова	Длина данных, слов
Код яркости	0000h	0001h
Код типа датчика	0001h	0001h
Порог срабатывания Реле K1	0002h	0001h
Порог срабатывания Реле K2	0003h	0001h
Гистерезис срабатывания Реле K1	0004h	0001h
Гистерезис срабатывания Реле K2	0005h	0001h
Алгоритм работы реле	0006h	0001h
Тип аналогового выхода	0007h	0001h
Код скорости, сетевой номер	0008h	0001h
Режим работы измерителя	0009h	0001h
Значение температуры, соответствующее нижнему значению диапазона выходного аналогового сигнала	000Ah	0001h
Значение температуры, соответствующее верхнему значению диапазона выходного аналогового сигнала	000Bh	0001h
Наименование прибора, номер версии встроенного программного обеспечения	5000h	0008h

«Код яркости» - старший байт – код яркости, младший - 0. Код яркости - это число от 0 до 31, причем 0 – отсутствие свечения индикатора, 31 – максимальная яркость.

3	Зам	УИМЯ.022-2018	06.08.18	УИМЯ.411600.072 РЭ	Лист 8
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Инв № подл		Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата

Номер типа датчика может принимать значения от 1 до 27 для ЦР9002 XXXX1  
или от 25 до 27 для ЦР9002 XXXX2.

Номер типа датчика	Тип применяемого ТС по ГОСТ 6651-2009	Обозначение типа ТС	$\alpha, ^\circ\text{C}^{-1}$	$R_0, \text{Ом}$	Схема подключения	
1	платиновый	Pt	0,00385	50	трехпроводная	
2		П	0,00391			
3		Pt	0,00385	100		
4		П	0,00391			
5	медный	М	0,00426	50	четырехпроводная	
6			0,00428			
7		М	0,00426	100		
8			0,00428			
9	никелевый	H	0,00617	100		
10	платиновый	Pt	0,00385	50	четырехпроводная	
11		П	0,00391			
12		Pt	0,00385	100		
13		П	0,00391			
14	медный	М	0,00426	50	четырехпроводная	
15			0,00428			
16		М	0,00426	100		
17			0,00428			
18	никелевый	H	0,00617	100		

Код	Обозначение термопары по СТБ ГОСТ Р 8.585-2004	Тип термопары
19	TXA	K
20	TNH	N
21	TXK	L
22	TXKh	E
23	TJK	J
24	TMK	T
25	ТПП (платина -13% родий/платина)	R
26	ТПП (платина -10% родий/платина)	S
27	TPR	B

«Порог срабатывания Реле K1» (далее -  $T_{K1}$ ) - число в двоичном дополнительном коде, может принимать значения от -1010 до 20000 (от минус 101°C до плюс 2000°C). Единицы представления – десятые доли градуса 0.1°C, шаг 1°C. Например, число 106 будет сохранено и обрабатываться далее как 100, порог срабатывания реле при этом 10.0°C. (10.0 °C).

«Порог срабатывания Реле K2» (далее -  $T_{K2}$ ) - описание аналогично «Порог срабатывания Реле K1».

«Гистерезис срабатывания Реле K1» - число в двоичном дополнительном коде, единицы представления – десятые доли градуса (0.1°C). Может принимать значения от 0 до 999 (от 0°C до 99.9°C). Значению 104 соответствует 10.4°C.


«Гистерезис срабатывания Реле K2» - описание аналогично «Гистерезис срабатывания Реле K1».

«Алгоритм работы реле» - 0 – реле не используются или отсутствуют  
1 - 0/1A  
2 - 0/1B  
3 - 0/1C

Лист	9			
Зам	УИМЯ.022-2018	06.08.18	УИМЯ.411600.072 РЭ	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв № подл	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата

4 – К1 превышение; К2 принижение

Алгоритм работы реле - 0/1А

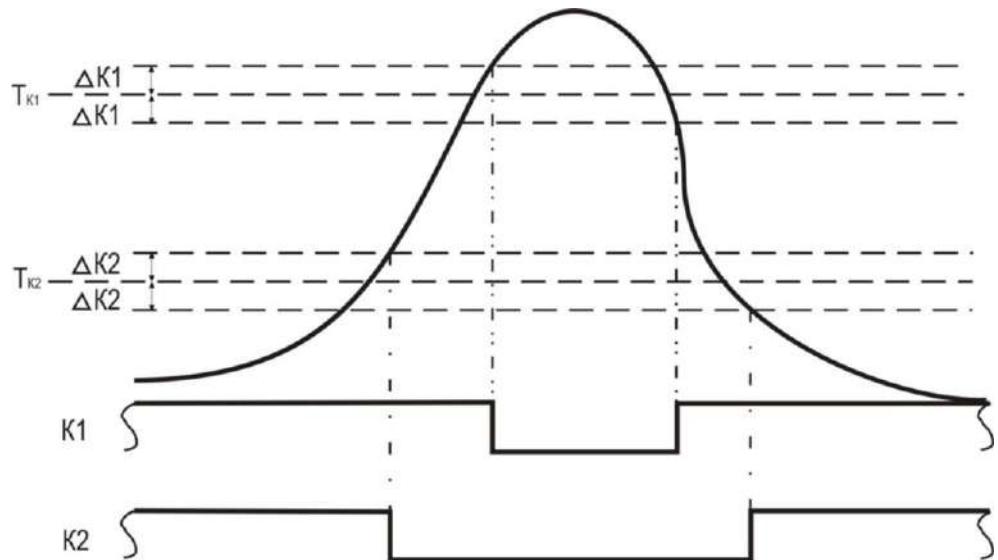

Прим. Высокий уровень означает, что реле замкнуто

$\Delta K_1$  - Гистерезис срабатывания Реле K1

$\Delta K_2$  - Гистерезис срабатывания Реле K2


$T_{k1}$  - Порог срабатывания Реле K1

$T_{k2}$  - Порог срабатывания Реле K2

Алгоритм работы реле - 0/1А это два независимых выходных канала управления с одной точкой измерения каждый.

Реле K1 замыкается при достижении значения  $T_{k1}$  минус  $\Delta K_1$ . Реле K1 размыкается при достижении значения  $T_{k1}$  плюс  $\Delta K_1$ . Реле K2 работает аналогично, но со значениями  $T_{k2}$  и  $\Delta K_2$ .

Алгоритм работы реле - 0/1В

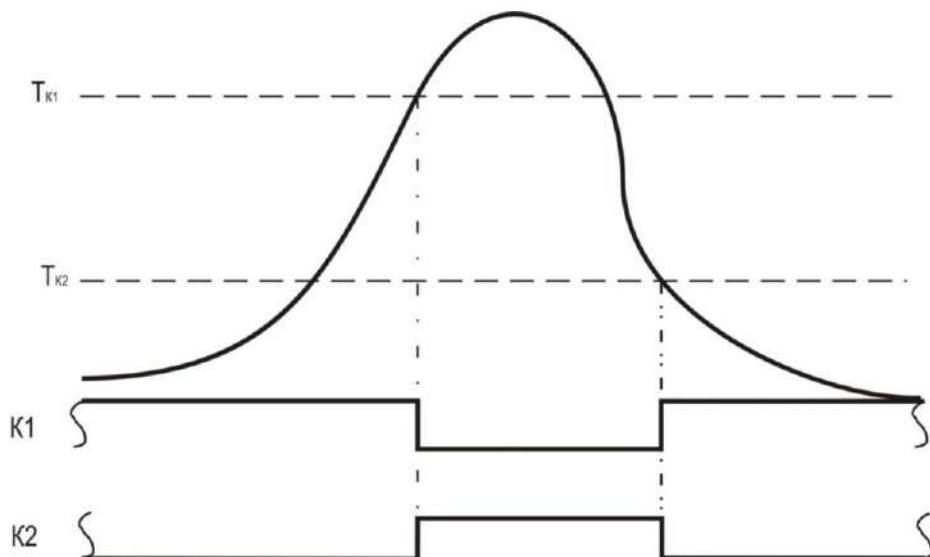

Прим. Высокий уровень означает, что реле замкнуто

$T_{k1}$  - Порог срабатывания Реле K1


$T_{k2}$  - Порог срабатывания Реле K2

Реле K1 управляет, например, работой нагревателя, а реле K2 - работой охладителя. Величины

З	Зам	УИМЯ.022-2018	06.08.18	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				УИМЯ.411600.072 РЭ
				10
Инв № подл	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата

$\Delta K_1$  и  $\Delta K_2$  в этом режиме не используются.

Алгоритм работы реле - 0/1С

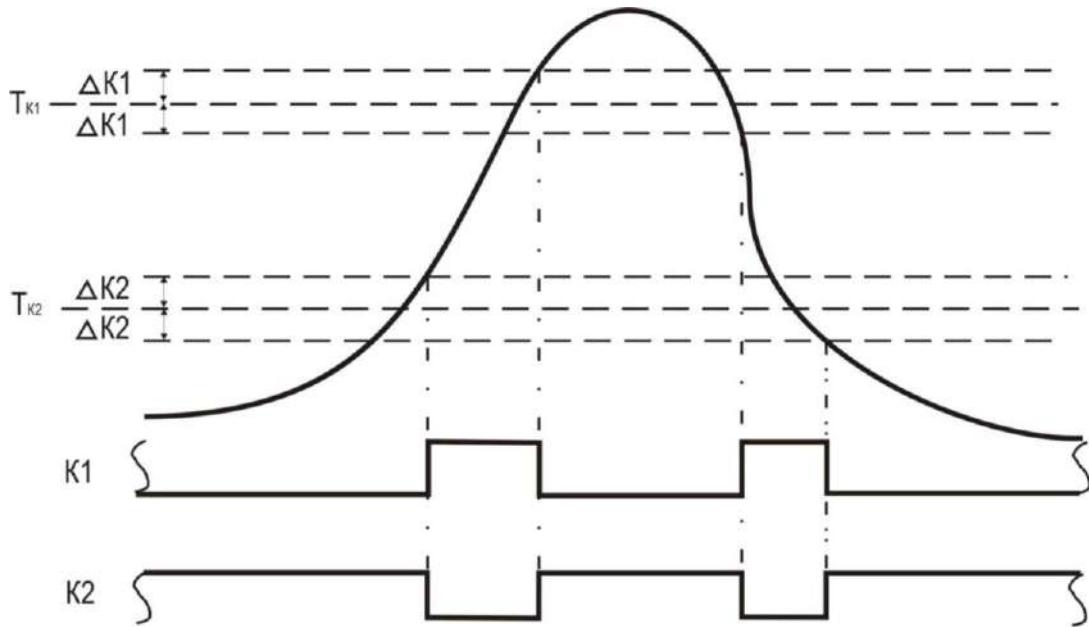

Прим. Высокий уровень означает, что реле замкнуто

$\Delta K_1$  - Гистерезис срабатывания Реле K1

$\Delta K_2$  - Гистерезис срабатывания Реле K2

$T_{k1}$  - Порог срабатывания Реле K1

$T_{k2}$  - Порог срабатывания Реле K2

Реле K1 замыкается при входении измеренной температуры в диапазон от  $T_{k2}$  - это нижнее значение, до  $T_{k1}$  - это верхнее значение.

Реле K2 замыкается при выходе измеряемой температуры из установленных границ.


Величины  $\Delta K_1$  и  $\Delta K_2$  в этом режиме рекомендуется устанавливать не более половины диапазона.

Алгоритм работы реле - K1 превышение; K2 принижение

Лист				
З	Зам	УИМЯ.022-2018	06.08.18	УИМЯ.411600.072 РЭ
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв № подл	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата

Лист

11

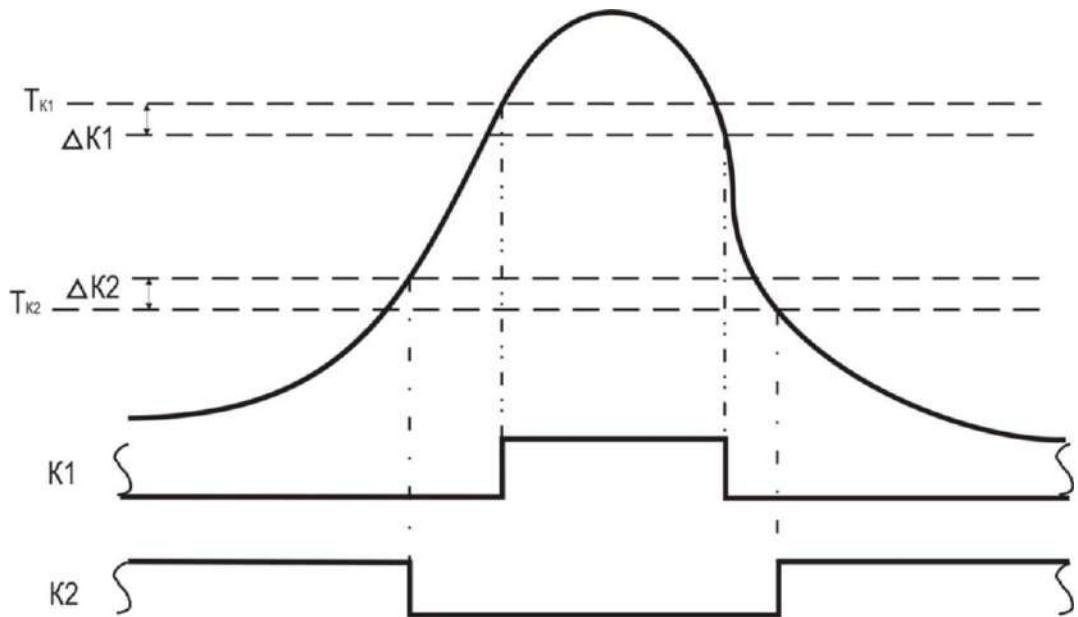

Прим. Высокий уровень означает, что реле замкнуто

$\Delta K_1$  - Гистерезис срабатывания Реле K1

$\Delta K_2$  - Гистерезис срабатывания Реле K2

$T_{K1}$  - Порог срабатывания Реле K1

$T_{K2}$  - Порог срабатывания Реле K2

Реле K1 замкнуто при температуре  $T_{K1}$  и выше, разомкнуто при температуре  $T_{K1}$  минус  $\Delta K_1$  и ниже. Реле K2 замкнуто при температуре  $T_{K2}$  и ниже, разомкнуто при температуре  $T_{K2}$  плюс  $\Delta K_2$  и выше.

- «Тип аналогового выхода» -
- 0 – отсутствует;
  - 1 – широкий диапазон ( $\pm 5$  или 0-20 мА);
  - 2 – узкий диапазон (0-5 или 4-20 мА).

«Код скорости, сетевой номер» - Старший байт – код скорости, младший – сетевой номер.

Возможные значения кода скорости: 0 – 1200 бод; 1 – 2400 бод; 2 – 4800 бод; 3 – 9600 бод; 4 – 19200 бод; 5 – 28800 бод. При выпуске из производства установлена скорость 9600.

«Сетевой номер» может принимать значения от 1 до 255. По умолчанию 255.

- «Режим работы измерителя» -
- 0 – включена компенсация разности сопротивления проводников, включена компенсация температуры холодного спая;
  - 1 – выключена компенсация разности сопротивления проводников, выключена компенсация температуры холодного спая.

«Значение температуры, соответствующее нижнему значению диапазона выходного аналогового сигнала» - число в двоичном дополнительном коде. Единицы представления – десятые доли градуса 0.1°C, с шагом 1°C. Например, число 106, соответствующее 10,6 °C, будет сохранено и обрабатываться далее как 100 (10.0 °C).

«Значение температуры, соответствующее верхнему значению диапазона выходного аналогового сигнала» - аналогично «Значение температуры, соответствующее нижнему значению диапазона выходного аналогового сигнала».

Значения температуры, соответствующие нижнему и верхнему значениям диапазона выходного аналогового сигнала, следует выбирать в пределах диапазона измерений текущего датчика. При этом диапазон для аналогового выхода должен быть не менее 25 % от диапазона измерений датчика.

3	Зам	УИМЯ.022-2018		06.08.18	УИМЯ.411600.072 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		12
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата

При попытке установить для аналогового выхода значения температуры вне диапазона текущего датчика, будут установлены значения, соответствующие нижнему и верхнему значениям текущего датчика. При попытке установить для аналогового выхода значения температуры менее 25% от диапазона измерения датчика, будут установлены значения соответствующие нижнему и верхнему значениям текущего датчика.

«Наименование прибора, номер версии» – Формат следующий (побайтно) –

До точки «Наименование прибора»:

коды KOI8-R - Ц(0E3h); Р(0F2h); 9(039h); 0(030h); 0(030h); 2(032h);

Точка .(02Eh)

После точки

«Номер версии»:

коды KOI8-R -0(030h); 1(031h);

Не используемые байты заполняются символом пробел (020h).

**Функция 4** предназначена для определения типа запрашиваемого прибора и получения кода, соответствующего поданному входному сигналу. Формат запроса для **функции 4**:

SLAVE	04	START	LENGTH	CRC
-------	----	-------	--------	-----

где SLAVE – адрес запрашиваемого прибора (1 байт);  
 04 – код функции (1 байт);  
 START – адрес начала запрашиваемых данных (2 байта, старший затем младший);  
 LENGTH – количество запрашиваемых данных (2 байта, старший затем младший);  
 CRC – контрольный циклический код.

Прибор ответит только в том случае, если START находится в диапазоне от 0000h до 0005h, а LENGTH – от 0001h до 0006h. При этом следует учесть следующее: START + LENGTH не должно превысить 0006h. Если START и (или) LENGTH находятся вне указанных диапазонов, прибор выдает исключение – «неправильный адрес или данные».

Формат ответа для **функции 4**:

SLAVE	04	BYTES	DATA...	CRC
-------	----	-------	---------	-----

где SLAVE – адрес ответившего прибора (1 байт);  
 04 – код функции (1 байт);  
 BYTES – количество передаваемых байт данных (1 байт);  
 DATA... – собственно данные, предназначенные к обмену;  
 CRC – контрольный циклический код.

Особенностью этой команды является то, что запрашиваются СЛОВА. В ответе всегда сначала старший байт, затем младший байт. Далее приведена таблица В.2, в которой сведены все возможные запрашиваемые данные с их адресами и длинами.

Таблица А.2

Наименование данных	Адрес начала данных, слова	Длина данных, слов
Код прибора, участвующего в обмене	0000h	0001h
Температура	0001h	0001h
Температура холодного спая	0002h	0001h
Величина входного сигнала	0003h	0002h
Код ошибки	0005h	0001h

«Код прибора, участвующего в обмене» – это СЛОВО, в котором закодированы отличительные признаки выбранного прибора. Описание отдельных битов кода прибора сведено в таблицу А.3. Если соответствующий бит установлен, значит справедливо назначение этого бита для данного прибора.

3	Зам	УИМЯ.022-2018	06.08.18	УИМЯ.411600.072 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.		13
Инв № подл	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата	

Таблица А.3

Номер бита	Назначение
15	Преобразователь действующего значения тока или напряжения
14	Преобразователь частоты переменного тока
13	Преобразователь активной мощности
12	Преобразователь реактивной мощности
11	Реле установлено в приборе
10	Преобразователь постоянного тока или напряжения
9	Имеется аналоговый выход
8	Имеется встроенное отсчетное устройство
7	Если "0" - ИП исправен, если "1" - неисправен
6	Преобразователь Е855ЭС-Ц.3
5	Для Е855ЭС-Ц.3 схема включения «1»-3х проводн. «0»-4х проводн.
4	Для Е855ЭС-Ц.3 аналог.вых «1»-фазн. напр. «0»-лин.напр.
3	Резерв
2	Устройство измерительное
1	Резерв
0	Всегда "0"

«Температура» – температура\*10. Может принимать значения в диапазоне от минус 1300 до плюс 20000 (от минус 130°C до плюс 2000°C). Данные представлены в двоичном дополнительном коде.

«Температура холодного спая» – температура\*10, измеренная на контактах прибора. Может принимать значения в диапазоне от минус 400 до плюс 600 (от минус 40°C до плюс 60°C). Значение минус 32000 означает неисправность при измерении температуры холодного спая. Данные представлены в двоичном дополнительном коде.

«Величина входного сигнала» - При подключении ТС - в миллиомах. При подключении термопары - в микровольтах. Может принимать значения в диапазоне от минус 20000 до 500000. Формат данных long. Данные представлены в двоичном дополнительном коде. Первым в ответе идет старший байт, далее 2-ой, 1-ый, младший.

«Код ошибки» - код ошибки

бит 0 – перегрузка вниз (обозначает, что сигнал на входе меньше нижней границы диапазона для заданного датчика);

бит 1 – перегрузка вверх (обозначает, что сигнал на входе больше верхней границы диапазона для заданного датчика);

бит 2 – неисправен датчик температуры холодного спая;

бит 3 – сопротивление проводников вне рабочего диапазона (только техпроводная схема подключения).

**Функция 6** предназначена для дистанционного программирования режимов работы. Формат запроса для функции 6:

SLAVE	06	START	DATA	CRC
-------	----	-------	------	-----

где SLAVE – адрес запрашиваемого прибора (1 байт);

06 – код функции (1 байт);

START – адрес регистра, участвующего в обмене (2 байта, старший затем младший);

DATA – данные, записываемые в регистр (2 байта, старший затем младший);

CRC – контрольный циклический код.

Прибор ответит только в том случае, если START находится в диапазоне от 0000h до 000Ch. Если START находится вне указанного диапазона, прибор выдает исключение – «неправильный адрес или данные».

3	Зам	УИМЯ.022-2018	06.08.18	УИМЯ.411600.072 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.		14
Инв № подл		Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата

**Формат ответа для функции 6:**

SLAVE	06	START	DATA	CRC
где SLAVE	адрес запрашиваемого прибора (1 байт);			
START	адрес регистра, участвующего в обмене (2 байта, старший затем младший);			
DATA	данные, записываемые в регистр (2 байта, старший затем младший);			
CRC	контрольный циклический код.			

Далее приведена таблица А.4, в которой сведены все возможные регистры с их адресами.

Таблица А.4

Наименование данных	Адрес начала данных, слова	Длина данных, слов
Код яркости	0000h	0001h
Тип датчика	0001h	0001h
Порог срабатывания Реле K1	0002h	0001h
Порог срабатывания Реле K2	0003h	0001h
Гистерезис срабатывания Реле K1	0004h	0001h
Гистерезис срабатывания Реле K2	0005h	0001h
Алгоритм работы реле	0006h	0001h
Тип аналогового выхода	0007h	0001h
Код скорости, сетевой номер	0008h	0001h
Режим работы измерителя	0009h	0001h
Значение температуры, соответствующее нижнему значению диапазона аналогового выхода	000Ah	0001h
Значение температуры, соответствующее верхнему значению аналогового выхода	000Bh	0001h
Регистр команд	000Ch	0001h

Назначение регистров такое же, как и в функции 3.

**Регистр команд** – в поле DATA надо указать код команды, в соответствии с выбранным действием:

55AAh – сохранить текущую конфигурацию (изменения, вносимые при помощи функции 6) в энергонезависимой памяти.

Исключения.

Если во время работы приходит неправильная команда или обнаруживается ошибка в поле CRC, прибор не дает ответа.

Если во время работы приходит команда с неправильными данными или неправильным адресом, то прибор отвечает особым образом.

Формат ответа исключения:

SLAVE	0x80 CMD	02	CRC
-------	----------	----	-----

где SLAVE	адрес запрашиваемого прибора (1 байт);
0x80 CMD	код функции, которая обнаружила ошибку с установленным старшим битом;
02	код ошибки «Неправильный адрес или данные»;
CRC	контрольный циклический код.

Лист	УИМЯ.411600.072 РЭ	15
3	Зам	УИМЯ.022-2018
Изм	Лист	№ докум.
		Подп.
		Дата
Инв № подл	Подп. и дата	Взам. инв №
		Инв. № подл
		Подп. и дата

Приложение Б  
(справочное)

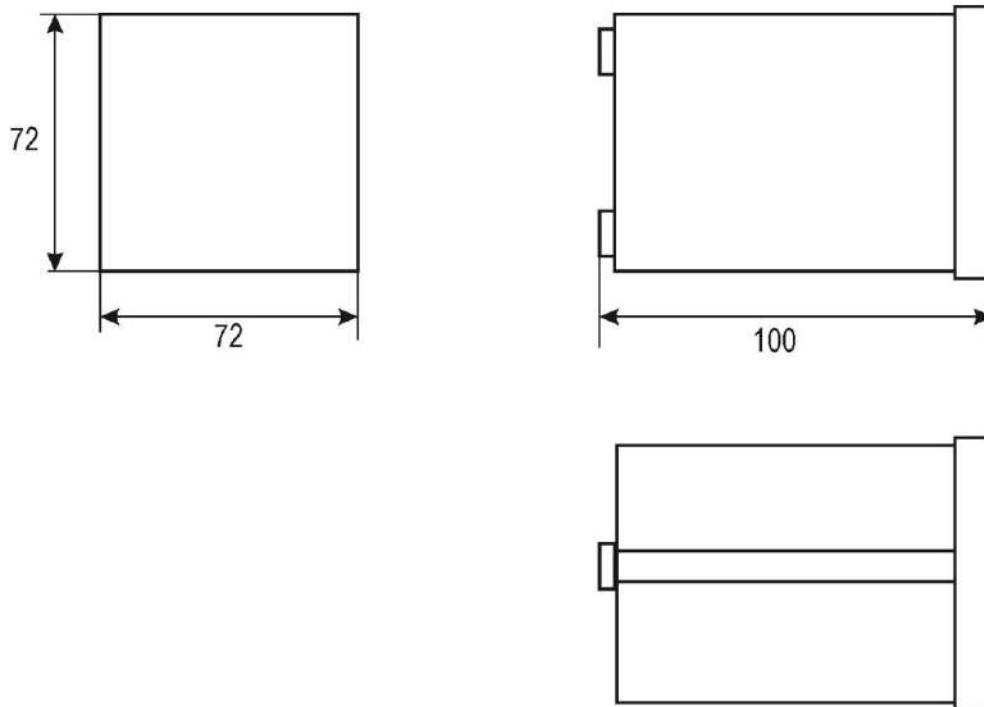


Рисунок Б.1 - Габаритные размеры измерителя

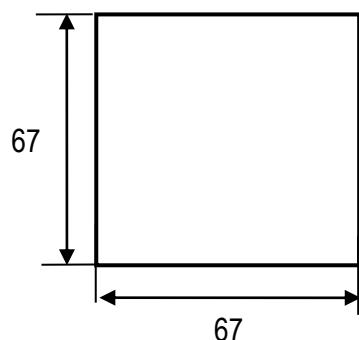






Рисунок Б.2 – Разметка щита для крепления измерителя

Лист				
З	Зам	УИМЯ.022-2018		06.08.18
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				УИМЯ.411600.072 РЭ
				16
Инв № подл	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата

Приложение В

(Обязательное)

Схема электрическая подключений термодатчиков при работе с измерителем

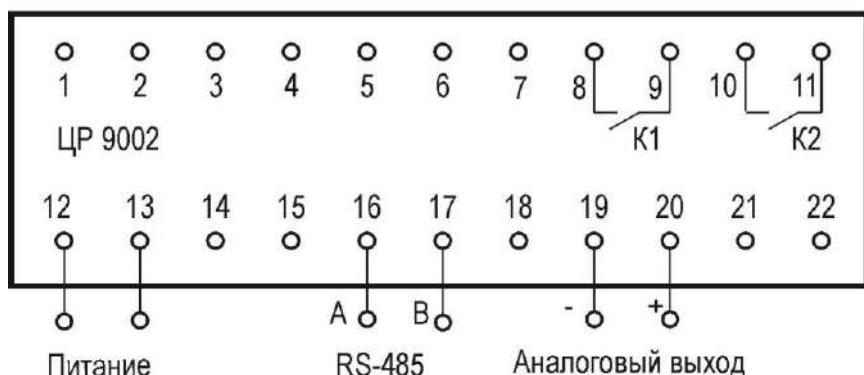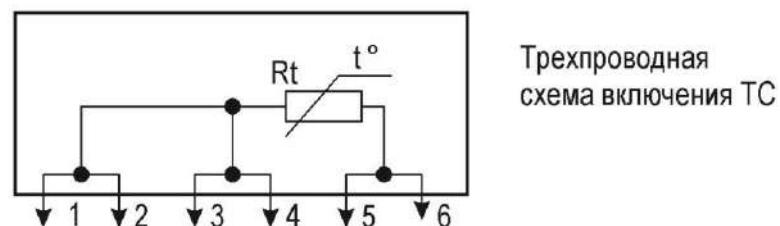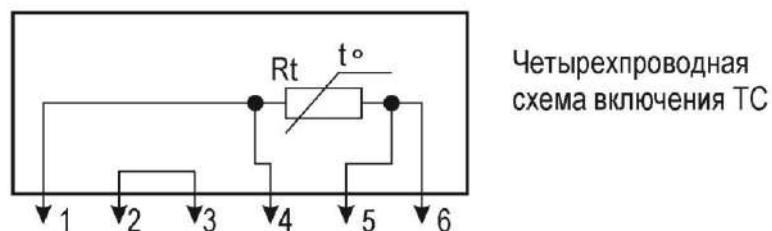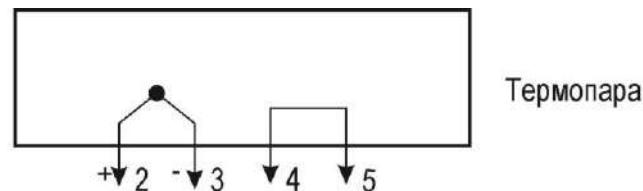

Примечания:

1 Цифры, приведенные под изображением термопары и термопреобразователей сопротивления, указывают, к каким контактам ЦР 9002 необходимо подключать соответствующий термодатчик при работе.

2 К1 и К2 – встроенные реле.

Рисунок В.1

З	Зам	УИМЯ.022-2018		06.08.18	УИМЯ.411600.072 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		17
Инв № подл		Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата	

Приложение Г  
(справочное)  
**Описание режимов индикации отсчетного устройства**

Расположенная на крышке прибора кнопка ВЫБОР (В) позволяет осуществить индикацию на ОУ информации, соответствующей выбранному режиму отображения.

Возможны два типа нажатия на кнопку: «короткое» нажатие (до 1 секунды), «длинное» нажатие (более 2 секунд).

При «коротком» нажатии происходит последовательный перебор режимов отображения:

1. Температура датчика холодного спая
2. Код яркости
3. Код типа датчика
4. Порог срабатывания Реле K1
5. Порог срабатывания Реле K2
6. Гистерезис срабатывания Реле K1
7. Гистерезис срабатывания Реле K2
8. Алгоритм работы реле
9. Тип аналогового выхода
10. Номер устройства при работе с MODBUS
11. Код скорости обмена при работе с MODBUS
12. Режим работы измерителя
13. Значение температуры, соответствующее нижнему значению аналогового выхода
14. Значение температуры, соответствующее верхнему значению аналогового выхода

и далее, начиная с первого по кольцу.

При отсутствии в приборе какого-либо функционального узла, его параметры не отображаются (пропускаются).

Если в течение пяти секунд не нажимать кнопку ВЫБОР, ОУ перейдет в основной режим отображения – режим отображения измеренного значения входного сигнала.


Чтобы изменить значение любого параметра, необходимо в режиме отображения соответствующего параметра осуществить «длинное» нажатие. При входе в режим изменения параметров начнет мигать старший разряд изменяемого параметра (при изменении порогов реле первым корректируется старший разряд, в котором может быть знак минус для отрицательных чисел). Короткое нажатие на кнопку ВЫБОР приведет к увеличению разряда на 1. Для режима корректировки порогов срабатывания реле, при корректировке старшего разряда, будет следующая последовательность: «знак минус» далее «0» и далее возрастание до «9», после чего опять «знак минус» и далее по кругу. Для перехода к изменению следующего разряда необходимо осуществить «длинное» нажатие. При переходе с самого младшего разряда («длинное» нажатие) новые настройки будут сохранены, при этом на индикаторе отобразится сохраненное значение. При отсутствии нажатий в режиме изменения параметров более 5 секунд прибор перейдет в режим отображения измеренного значения входного сигнала, новые настройки при этом не будут сохранены.

Пример отображаемой на ОУ информации в разных режимах работы:

Основной режим:

Если номер типа датчика выбран от 1 до 18, либо равен 21 или 24, то запятая в третьем разряде (слева направо):


Лист	Зам	УИМЯ.022-2018	06.08.18	УИМЯ.411600.072 РЭ	18
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Инв № подл	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата	

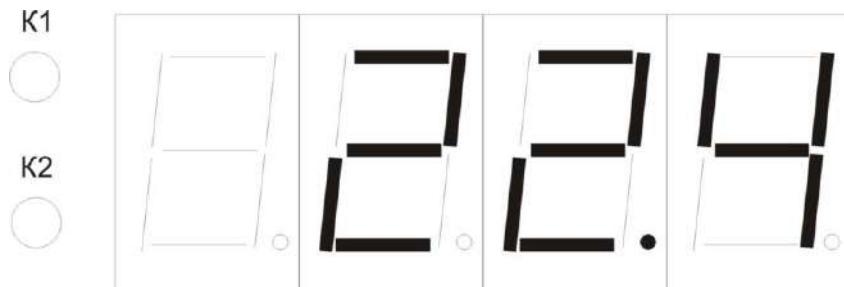

T<sub>хс</sub>



Для остальных датчиков запятая в четвертом разряде:

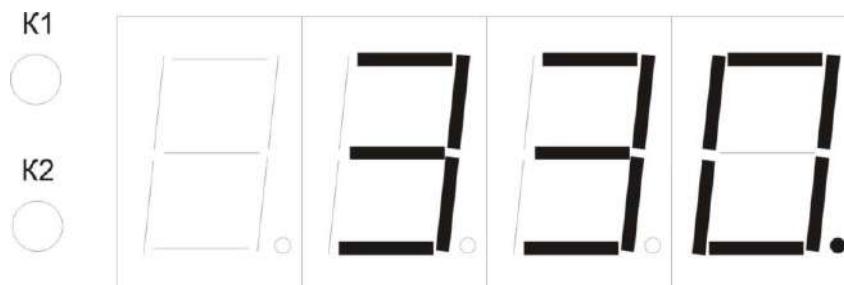


T<sub>хс</sub>



При замыкании реле будет светиться соответствующий светодиод.

1. Температура датчика холодного спая  
(при этом непрерывно светится светодиод, обозначенный T<sub>хс</sub>)

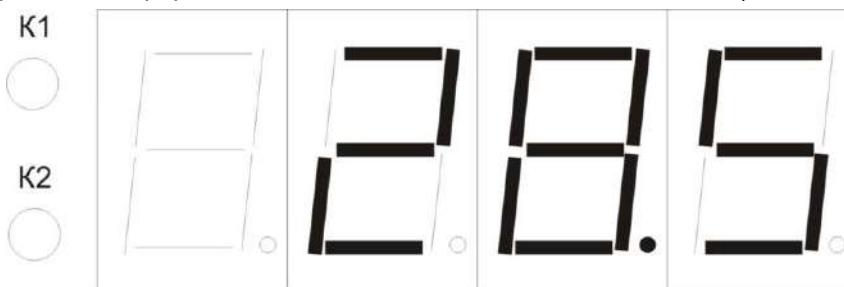


T<sub>хс</sub>



З	Зам	УИМЯ.022-2018		06.08.18	УИМЯ.411600.072 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		19
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата

2. Код яркости

Может принимать значения от 0 до 3.

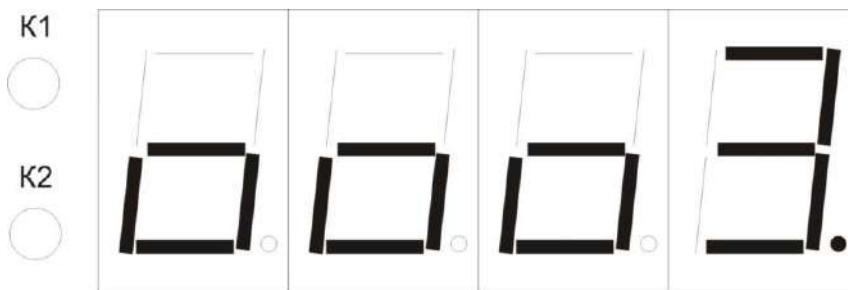


Txs



3. Номер типа датчика

Может принимать значения от 1 до 27 для ЦР9002 XXXX1

или от 25 до 27 для ЦР9002 XXXX2.

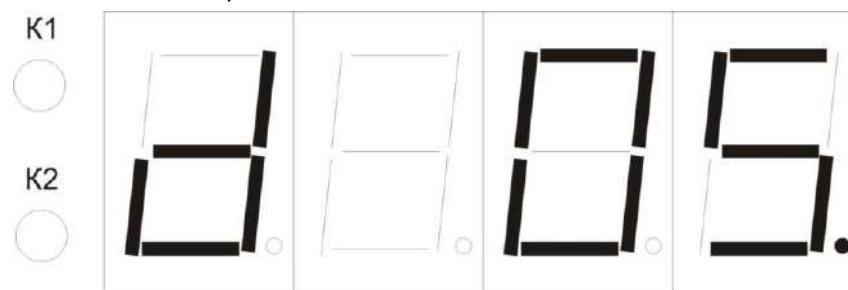


Txs



4. Порог срабатывания Реле K1

(при этом мигает светодиод, обозначенный K1)

Может принимать значения от минус 101°C до плюс 2000°C

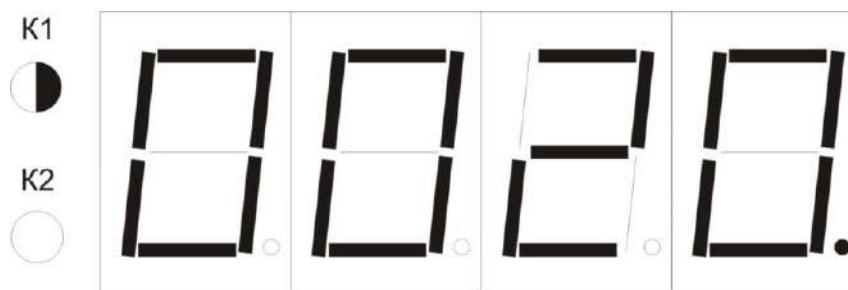


Txs




Лист	УИМЯ.411600.072 РЭ			
3	Зам. 06.08.18 УИМЯ.022-2018 № докум.			
Изм	Лист	Подп.	Дата	
Инв № подл	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата

5. Порог срабатывания Реле K2  
(при этом мигает светодиод, обозначенный K2)  
Может принимать значения от минус 101°C до плюс 2000°C

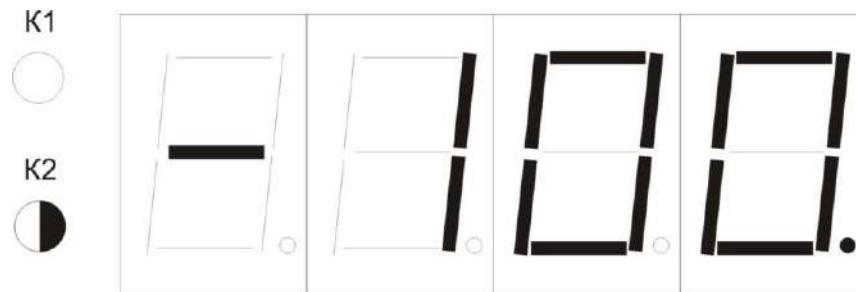


T<sub>xc</sub>

6. Гистерезис срабатывания Реле K1  
Может принимать значения от 0°C до 99.9°C.

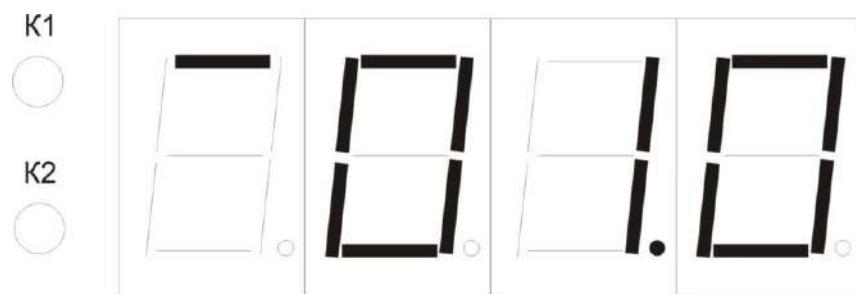

T<sub>xc</sub>

7. Гистерезис срабатывания Реле K2  
Может принимать значения от 0°C до 99.9°C.

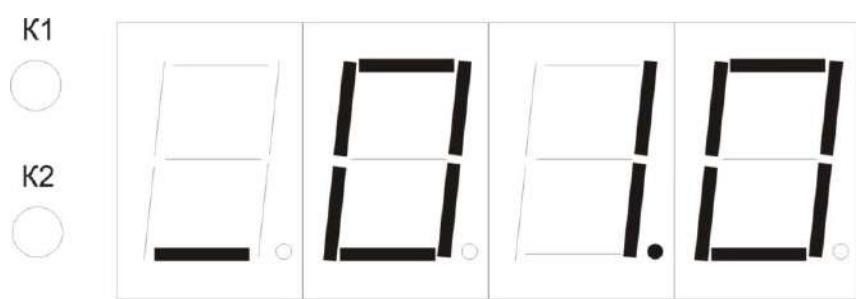


З	Зам	УИМЯ.022-2018		06.08.18	УИМЯ.411600.072 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		21
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата

8. Номер алгоритма работы реле

K1



K2

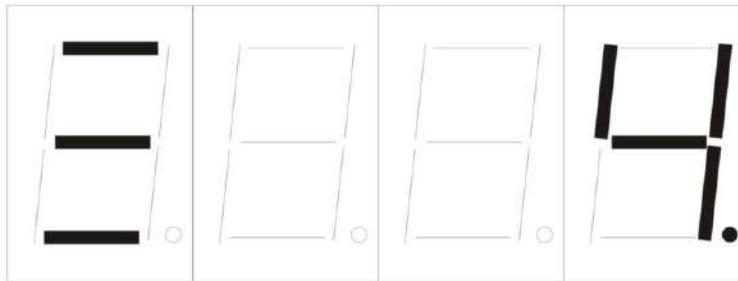

Txs




9. Тип аналогового выхода

K1



K2

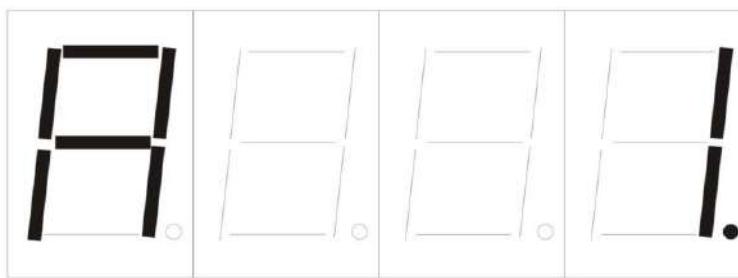

Txs



«Тип аналогового выхода» -

0 – аналоговый выход отсутствует;

1 – широкий диапазон

2 – узкий диапазон

Примечание:

Для измерителей, изготовленных с номинальным значением аналогового выхода 20 мА, широкий диапазон: от 0 до 20 мА, узкий диапазон: от 4 до 20 мА.

Для измерителей, изготовленных с номинальным значением аналогового выхода 5 мА, широкий диапазон: от минус 5 до плюс 5 мА, узкий диапазон: от 0 до 5 мА.


10. Номер устройства при работе с MODBUS

Может принимать значения от 1 до 255. При выпуске из производства установлен номер 255.

K1



K2

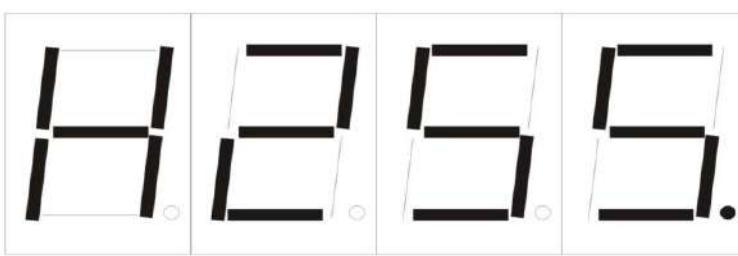


Txs



									Лист
З	Зам	УИМЯ.022-2018		06.08.18		УИМЯ.411600.072 РЭ			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					22
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №		Инв. № подл		Подп. и дата	


## 11. Код скорости обмена при работе с MODBUS

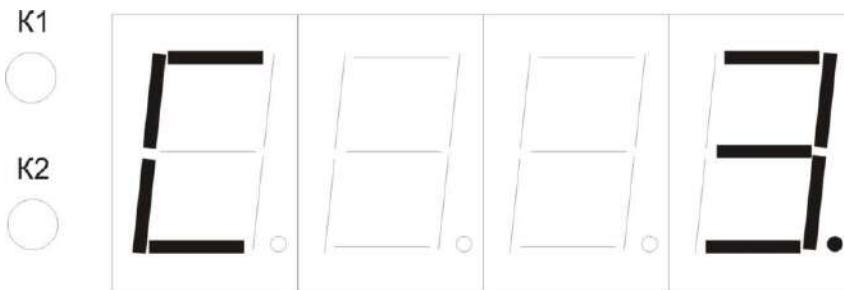

Txs

Возможные значения кода скорости: 0 – 1200 бод; 1 – 2400 бод; 2 – 4800 бод; 3 – 9600 бод; 4 – 19200 бод; 5 – 28800 бод; При выпуске из производства установлена скорость 9600.

## 12. Режим работы измерителя

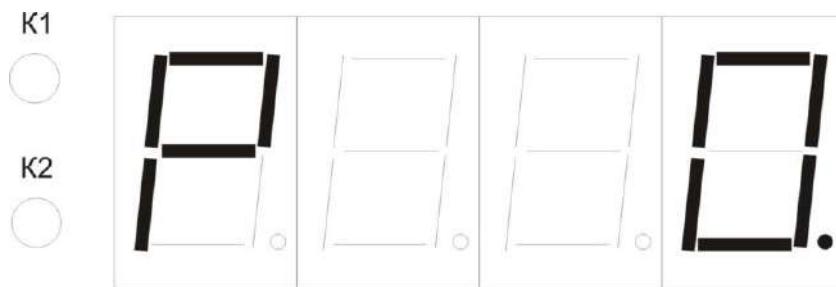


Txs

«Режим работы измерителя» -

0 – включена компенсация разности сопротивления проводников, включена компенсация температуры холодного спая;  
 1 – выключена компенсация разности сопротивления проводников, выключена компенсация температуры холодного спая.


## 13. «Значение температуры, соответствующее нижнему значению аналогового выхода» - (при этом мигают светодиоды, обозначенные K2 и Txс)

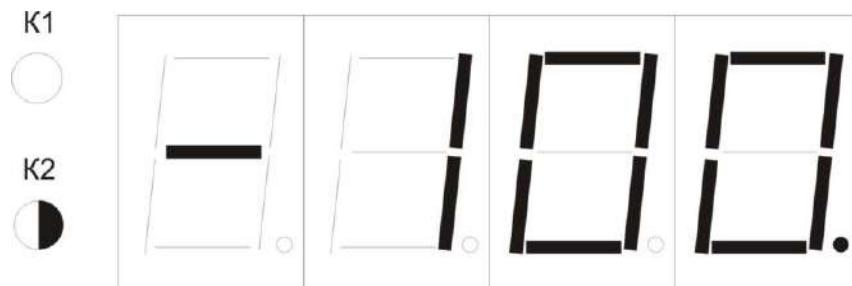

Txs

					Лист
З	Зам	УИМЯ.022-2018		06.08.18	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УИМЯ.411600.072 РЭ
					23
Инв № подл		Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата

14. «Значение температуры, соответствующее верхнему значению аналогового выхода» - (при этом мигают светодиоды, обозначенные K1 и Txс)

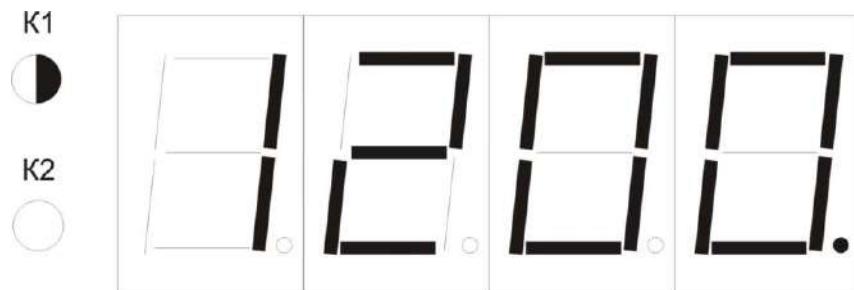


Txс



В ЦР9002 предусмотрена компенсация разности сопротивлений проводников для трехпроводной схемы включения. Для осуществления компенсации необходимо:

Выбрать соответствующий датчик, подключить прибор для измерения с использованием трехпроводной схемы включения и в качестве датчика установить образцовую катушку сопротивления 100 Ом (например Р310). Далее, при включении прибора удерживать кнопку «Выбор» в нажатом состоянии. Если вход в режим настройки компенсации разности сопротивлений проводников осуществлен удачно, то на отсчетном устройстве будет отображено сопротивление датчика, при этом цифра будет мигать. При одинаковых сопротивлениях проводников мы увидим число 100.0, если сопротивления проводников отличаются, то мы увидим число отличное от 100.0.

Для настройки компенсации разницы сопротивлений проводников нужно осуществить длинное нажатие на кнопку «Выбор». После этого прибор покажет сопротивление 100.0 (Ом) и перейдет в основной режим отображения.

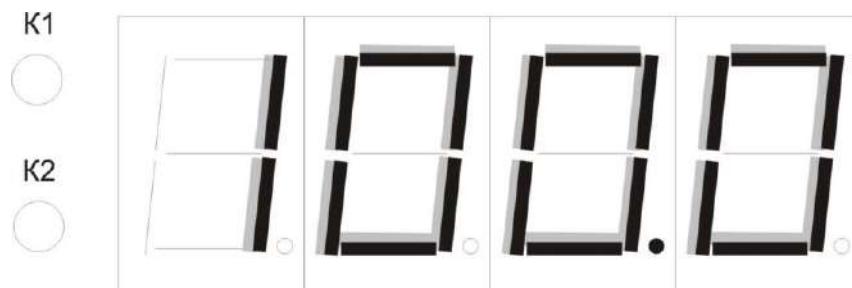

Txс




Лист	3	Зам	УИМЯ.022-2018	06.08.18	УИМЯ.411600.072 РЭ	24
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Инв № подл		Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата	

При невозможности осуществить компенсацию будут мигать точки в каждом разряде.

В ЦР9002 предусмотрены сообщения о наличии ошибок:


Перегрузка вниз: (обозначает, что сигнал на входе меньше нижней границы диапазона для заданного датчика)

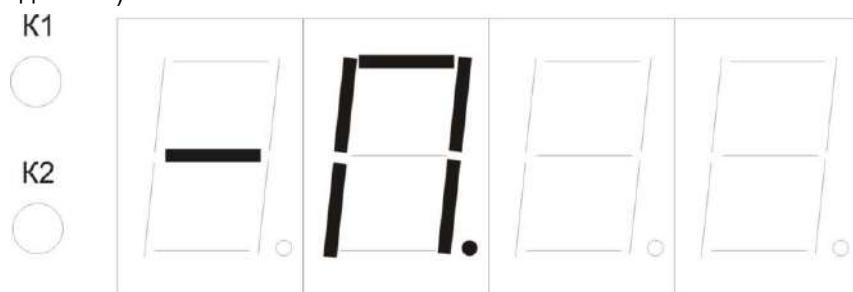

Txs




Перегрузка вверх: (обозначает, что сигнал на входе больше верхней границы диапазона для заданного датчика)

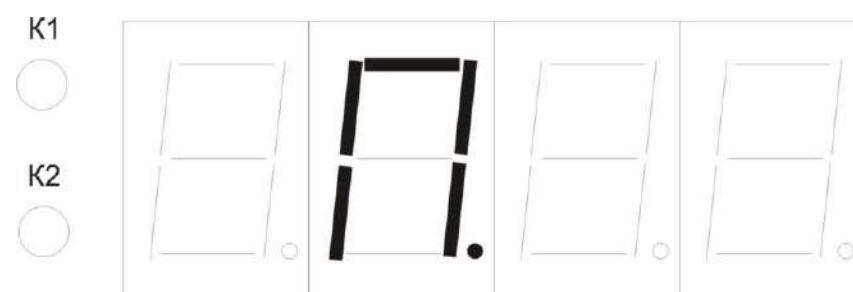

Txs



Неправильность датчика температуры холодного спая:

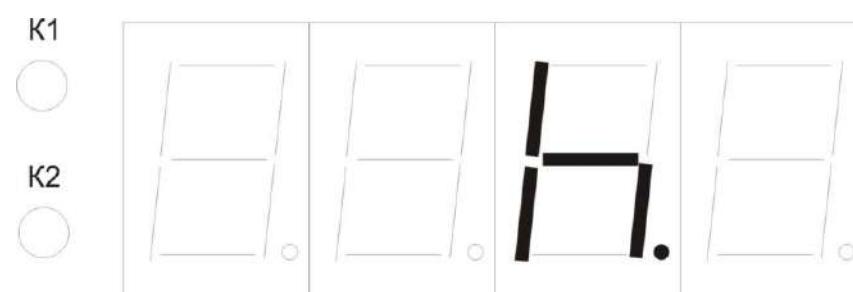

Txs




3	Зам	УИМЯ.022-2018		06.08.18	УИМЯ.411600.072 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		25
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата

Сопротивление проводников больше нормы:

K1



K2

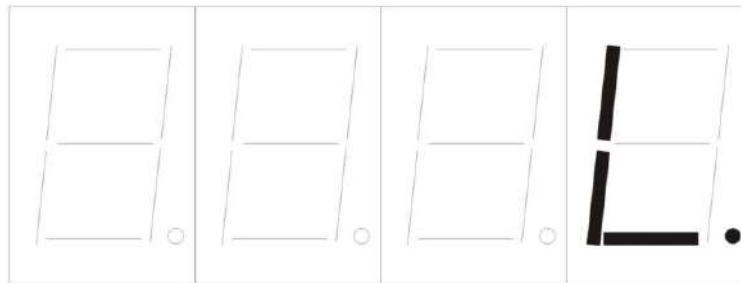

Txs




При этом следует учесть, что возможно появление сразу нескольких неисправностей одновременно. Тогда на отсчетном устройстве мы можем увидеть:

K1



K2

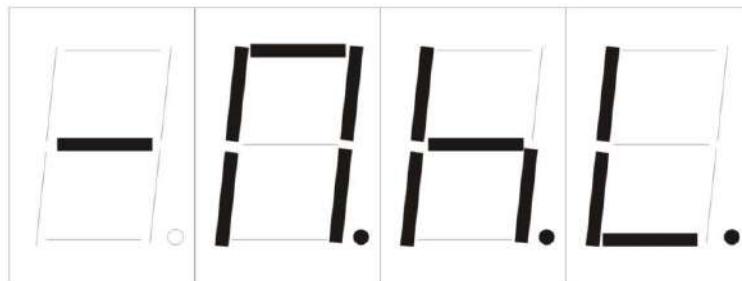

Txs



Эта информация сообщает о наличии следующих ошибок: перегрузка вниз, неисправность датчик температуры холодного спая и сопротивление линии выше нормы.

3	Зам	УИМЯ.022-2018		06.08.18	УИМЯ.411600.072 РЭ	Лист 26
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Инв № подл		Подп. и дата		Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата

Приложение Д  
(рекомендуемое)

При заказе и в документации другой продукции, в которой измерители могут быть применены, необходимо указать тип прибора, цифровой код, определяющий наличие порта RS-485, наличие встроенных реле, параметры выходного аналогового сигнала, вариант питания, код типа термодатчиков, с которыми может работать измеритель, обозначение технических условий.

ЦР 9002 X X X X X ТУ BY 300521831.072-2013

Код типа термодатчиков, с которым может работать измеритель

1 - все ТС и все термопары

2 - термопары R, S, B

Питание

1 - от источника напряжения переменного тока 220 В 50 Гц;

2 - от источника напряжения переменного тока 220 В или напряжения постоянного тока 220 В;

3 - от источника напряжения постоянного тока 24 В

Наличие аналогового выхода и номинальное значение диапазона изменения выходного аналогового сигнала

0 - аналоговый выход отсутствует

1 - 5 мА;

2 - 20 мА

Реле

0 - отсутствуют;

1 - присутствуют

Порт RS-485

0 - отсутствует;

1 - присутствует

Коду 1 типа термодатчиков соответствует измеритель, имеющий класс точности 0,5 при работе со всеми типами ТС и с термопарами типа J, T, E, K, N, L, и имеющий класс точности 1,0 при работе с термопарами типа R, S, B.

Коду 2 типа термодатчиков соответствует измеритель, имеющий класс точности 0,5 при работе с термопарами типа R, S, B.

Датчика температуры в комплекте нет. Может быть поставлен по отдельному заказу.

Пример условного обозначения при заказе измерителя ЦР 9002 с портом RS-485, с реле, с номинальным значением выходного аналогового сигнала 20 мА, с питанием от источника напряжения от 85 до 264 В (номинальное значение 220 В) переменного тока частотой 50 Гц или от источника напряжения от 120 до 300 В (номинальное значение 220 В) постоянного тока, предназначенного для работы со всеми типами ТС и со всеми типами термопар:

ЦР 9002 1 1 2 2 1 ТУ BY 300521831.072-2013.

**ЗАКАЗАТЬ**

Лист				
3	Зам	УИМЯ.022-2018	06.08.18	УИМЯ.411600.072 РЭ
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв № подл	Подп. и дата	Взам. инв №	Инв. № подл	Подп. и дата