

**Вариант поставки**

Наименование:

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> СП1 – 1500            | <input type="checkbox"/> СП2 – 1500 |
| <input type="checkbox"/> СП1 – 1200            | <input type="checkbox"/> СП2 – 1200 |
| <input type="checkbox"/> СП1 – 900             | <input type="checkbox"/> СП2 – 900  |
| <input type="checkbox"/> СП1 – 600             | <input type="checkbox"/> СП2 – 600  |
| <input type="checkbox"/> Изготовление на заказ |                                     |



ООО «Фирма «Альфа БАССЕНС»

**ЗАКАЗАТЬ**

Стойка приборная

ПАСПОРТ

НЖЮК.1.010.003.000

**Контактная информация**

ООО «Фирма «Альфа БАССЕНС»

143987 г. Железнодорожный-7, а/я 39

Тел./Факс: (495) 362-70-26, 362-70-54, 525-06-60

(499) 270-64-96

Производитель не распространяет гарантийные обязательства на естественный износ элементов устройства. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и данный документ без предварительного уведомления. Производитель постоянно совершенствует конструкцию, поэтому изображения в данном документе могут незначительно отличаться от изделий, получаемых потребителем.

## Назначение

Стойка приборная предназначена для установки устройств подготовки пробы УППА1, УППА2, УППА3, УППА0, анализаторов АКПИМ-01, АВП-01, ПАИС-01рН, ПАИС-01рNa, АКП-01 производства ООО «Фирма «Альфа БАССЕНС» и организации стоек для автоматического химического контроля воднохимического режима.

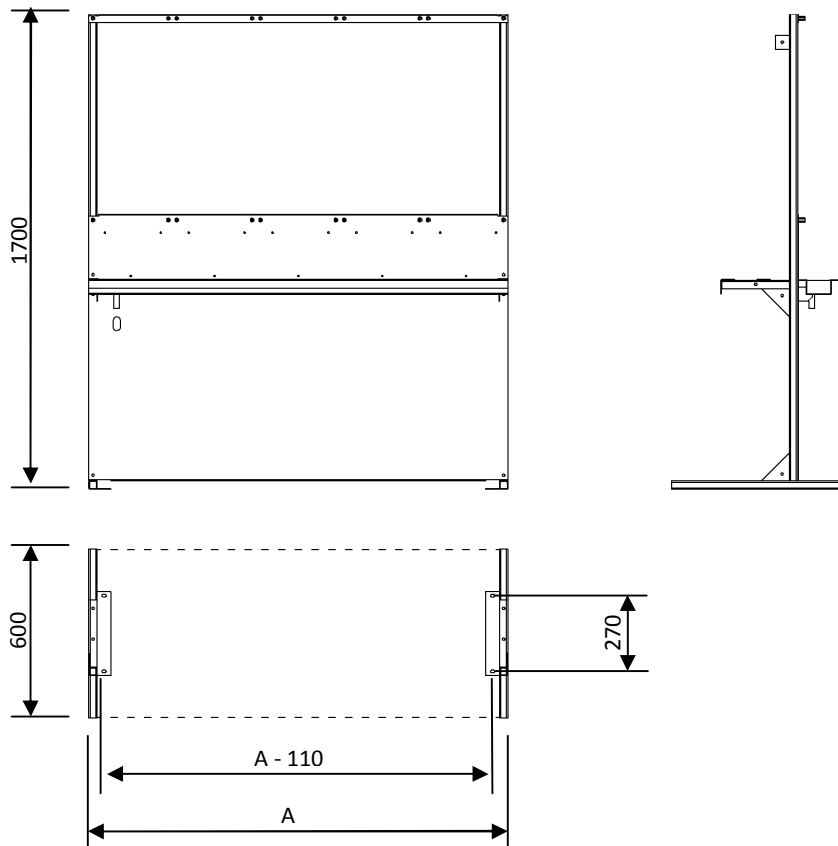


Рис. 1. Стойка приборная.  
Показана СП1-1500

## Исполнения стоек

Модель	Обозначение	А	Места для панелей	Для теплообменников или ионообменных колонок
СП1-1500	НЖЮК.1.010.003.000	1500	5	5
СП1-1200	-01	1200	4	4
СП1-900	-02	900	3	3
СП1-600	-03	600	2	2
СП2-1500	-00.01	1500	10	-
СП2-1200	-01.01	1200	8	-
СП2-900	-02.01	900	6	-
СП2-600	-03.01	600	4	-

## Варианты исполнения панелей анализаторов:

Модель	Анализатор	Наименование	Размеры, мм	Каналов измерения
ПП-АКПИМ-01	АКПИМ-01, АВП-01	О <sub>2</sub> , Н <sub>2</sub>	750x300	1
ПП-ПАИС-01рН	ПАИС-01рН *	рН		1
ПП-ПАИС-01рNa	ПАИС-01рNa *	рNa		1
ПП-АКП-01	АКП-01	Кондуктометр		1
ПП-АКП-012	АКП-012	Кондуктометр	-	2
ПП-0	-	Свободная	-	-
ПП-3	-	По заказу	-	-

\* Анализаторы ПАИС-01рН и ПАИС-01рNa поставляются в сборе с панелями.

Анализаторы АКПИМ-01, АВП-01, АКП-01 и АКП-012 поставляются в сборе с панелями по заказу.

При необходимости панели дорабатываются на месте монтажа, или изготавливаются по заказу.

## Гарантия производителя

1. Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении Потребителем условий эксплуатации - 24 месяца со дня продажи.
2. Гарантийный срок хранения без переконсервации при соблюдении правил хранения - 3 года.
3. В течение гарантийного срока при соблюдении потребителем правил эксплуатации предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие.

**ЗАКАЗАТЬ**